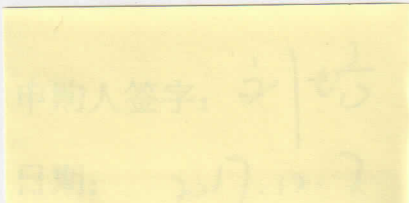


仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称	溶出试验仪	申购信息	80005726
参考品牌型号(选填)			
主要用途描述：用于测量药物溶出度			
<p>参数要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 搅拌桨摆动幅度：$\leq 0.5\text{mm}$ 2. 转篮摆动幅度：$\leq 1.0\text{mm}$ 3. 转杆与溶出杯轴偏差：$\leq 2.0\text{mm}$ 4. 调速范围：25—250 转/分 5. 转速分辨率：1 转/分 6. 稳速误差：$\leq \pm 4\%$ 7. 调温范围：5°C（室温）—45°C 8. 温度分辨率：0.1°C 9. 控温误差：$\leq \pm 0.3^{\circ}\text{C}$ 10. 程控取样次数：≤ 12 次 11. 程控取样周期：≤ 99 小时 59 分钟 12. 工作噪声：$< 60\text{dB}$ 13. 可放置 12 个 185mm 高度新溶出杯、12 个转杆 14. 机头电动升降 15. 转杆与溶出杯自动对中心定位 16. 有防止溶出介质蒸发的密封杯盖 17. 定时关机、定时自动预热功能 <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  </div>			

备注：

- 1、单价或批量在 1 万元以上的专用设备，必须提交本表格；
- 2、从江苏省省属高校国有资产管理信息系统提交的申购，应在申购信息一栏填写完整的申购单单号，采用纸质申购单完成的申购，应在申购信息一栏填写“线下申购”，并与申购单同时提交；除本表单外，申购人还应提交本表单的电子版本。
- 3、申购人签字一栏应与申购单保持一致。