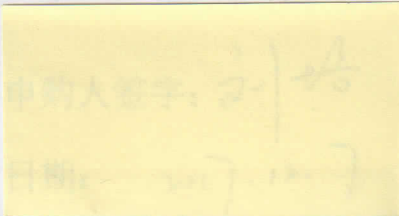


仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称	锥入度计	申购信息	80005733
参考品牌型号(选填)			
主要用途描述：用于软膏剂和眼膏剂的粘稠度测定			
<p>参数要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 锥体质量：标准锥 102.5g±0.05g，锥杆 47.5g±0.05g 2. 容器尺寸：标准容器直径 100mm*65mm 3. 锥入度测量分辨率：0.01mm 4. 锥入度最大测量值：65mm 5. 锥入时间：5~99s 6. 锥入度精度：同一仪器重复性：2±0.02P；不同仪器的再现性：9±0.05P，P 为两个测定结果的算术平均值，两个测定结果之差不得大于上述值 7. 软件可进行多次平均值及 RSD 值计算并打印测试结果 8. 带 LED 光源 <div style="text-align: right; margin-top: 100px;">  </div>			

备注：

- 1、单价或批量在 1 万元以上的专用设备，必须提交本表格；
- 2、从江苏省省属高校国有资产管理系统提交的申购，应在申购信息一栏填写完整的申购单单号，采用纸质申购单完成的申购，应在申购信息一栏填写“线下申购”，并与申购单同时提交；除本表单外，申购人还应提交本表单的电子版本。
- 3、申购人签字一栏应与申购单保持一致。